


Impulzusüzemi letőteri feszültség vizsgáló

multivibrátor

röv. zár. áramkör

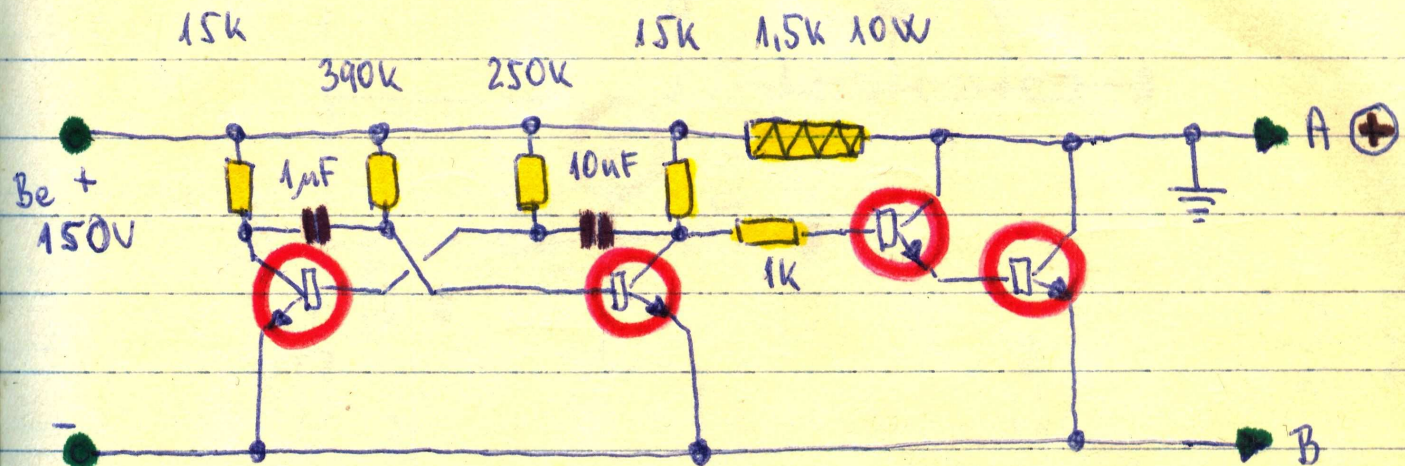


2 x BF 259

BF 178 2N3055
BVY 12

100µA
2 mA
10 mA

100k 47 k
2,7k 4,7k
470 1k

Áramstabilizátor

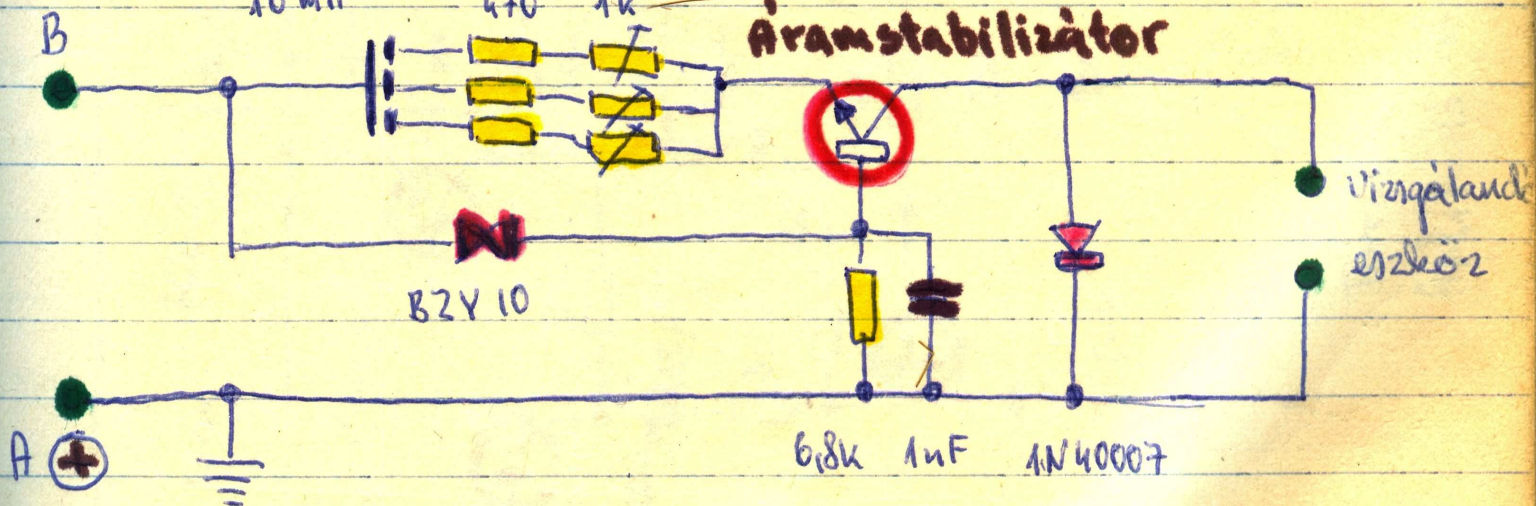

leolvasás: kalibrált oscilloszkóppal

A mérendő félvezető védelméről gondoskodni kell!